Sterifilt

NOPEA SUODATUS

Sterifilt® on hiukkassuodatin, joka on kehitetty yksinomaan riskien vähentämiseksi.

Tavoitteet:

- Suojaa laskimot
- Estää märkäpesäke, sydämen sisäkalvon tulehduksia ja keuhkoihin liittyviä komplikaatioita
- Välttäkää saman suodattimen undelleen, käyttämista ; vähentää hepatiitti C:n riskiä
- **Suodatta** helposti ja nopeasti

Apothicom
Tools for harm reduction

52, avenue Edison
75013 Paris
+33 (0)1 53 61 18 41
www.apothicom.org

Sterifilt® on luokan IIa lääketieteellinen steriili laite, jossa on CE-merkintä (CE 0434; CE 0459).

Ehkäisee paiseita, sydämen sisäkalvon tulehduksia ja keuhkoihin liittyviä komplikaatioita

Suuremmat kuin 10 µm:n **liukenemattomat partikkelit** ovat läsnä lähes kaikissa injectoiduissa liuksissa.

→ Ne **vahingoittavat laskimoita** ja **estävät keuhkoaluksia**.
→ Ne **lisäävät myös paiseita ja sydämen sisäkalvon tulehduksia.**

Poistamalla lähes kaikki yli 10 µm:n hiukkaset, **Sterifilt vähentää merkittävästi näitä riskejä**.

Liuoksessa yli 10 µm:n hiukkasten määrä suodatuksen jälkeen

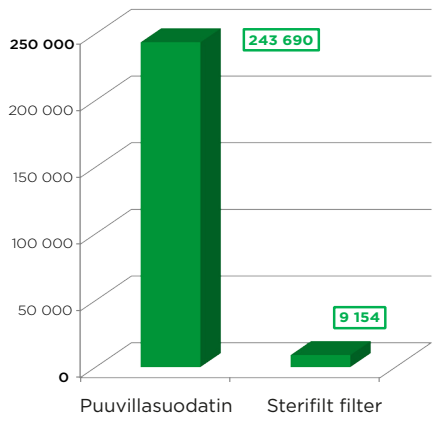

Morfiinisulfaatti valmistettu ja lämmitetty*

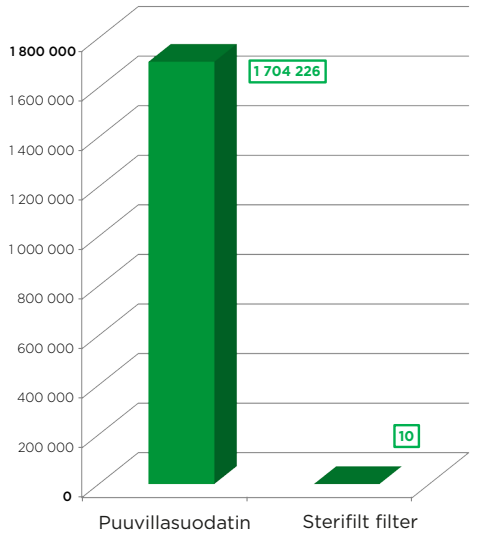

Buprenorfiini**

** Morfiinisulfaatti suodattamaton: 4 547 674 hiukkasta*

*** Buprenorfiini suodattamaton: 8 149 598 hiukkasta*

Vähentää bakteeri-, sieni- ja virusinfektioita

Niiden käsittelyn aikana suodattimet (savuke, puuvillan pala) ovat usein saastuneita bakteereista ja sienistä. Sterifiltin muotoilu estää käsien suoraa kosketusta sen suodatusosan kanssa. Se on lisäksi jaettu steriileihin läpipainopakkauksiin.

Suodattimien uudelleenkäyttö ja jakaminen ovat yhteinen syy HCV-tartuntaan[1].
Ihmiset, jokta käyttävät uudelleen tai jakavat suodattimia, ovat 2,4 - 16,4 kertaa todennäköisemmin riskissä saada tartunna. Kalvosuodattimet ovat vähemmän käytettyjä kuin puuvillasuodattimet tai savukkeen suodattimet.

Sterifilt mahdollistaa erittäin nopean suodatuksen, mukaan lukien suun kautta annettavat lääkkeet. Uusien käyttäjien keskuudessa:

→ 87,2% osoittaa, että sitä on helppo käyttää,
→ 85,9% uskoo, että se on sovitettu heidän tarpeisiinsa,
→ 83,7%, että suodatusaika on (erittäin) tyydyttävä,
→ 86%, että suodatin on tehokas.

[1] Useat luokat osoittivat, että puuvillasuodattimien jakaminen oli vahva indikaattori HCV-serkonversiolle (säädetty vertailusuhde 16,4 - Bruandet et al. 2006, 2,4 - Torpe et al. 2002, ja 2,83 - Hagan et al. 2010).

Huom: Sterifilt poistaa liukenemattomat hiukkaset liuoksesta, mutta ei bakteereista eikä viruksia.
Useimmat infektiot ovat peräisin ihon bakteereista tai ympäristöstä.
Sinun on käytettävä **steriilejä laitteita, pese kätesi, desinfio pistospaikka** ja **älä nuole neulaa**.